

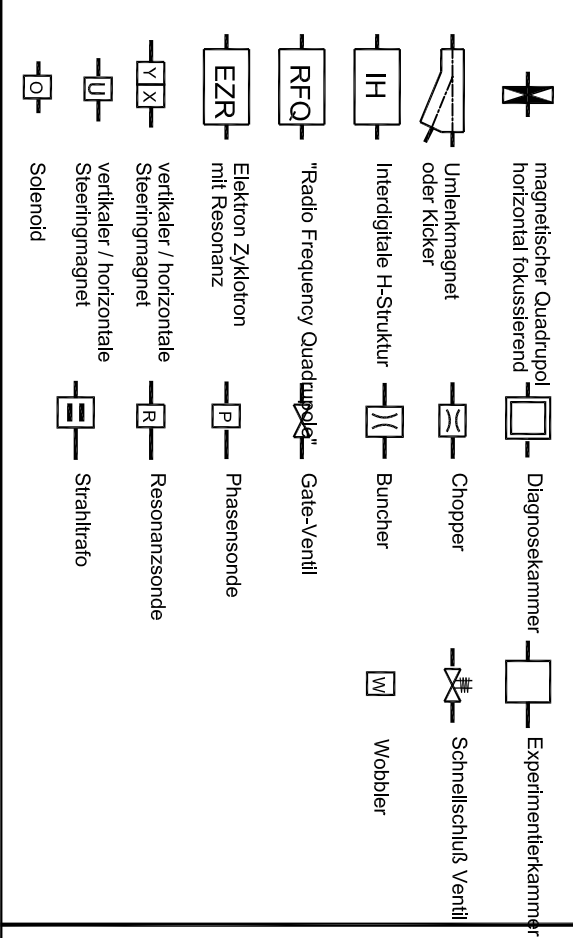


Bildzeichen Erklärung

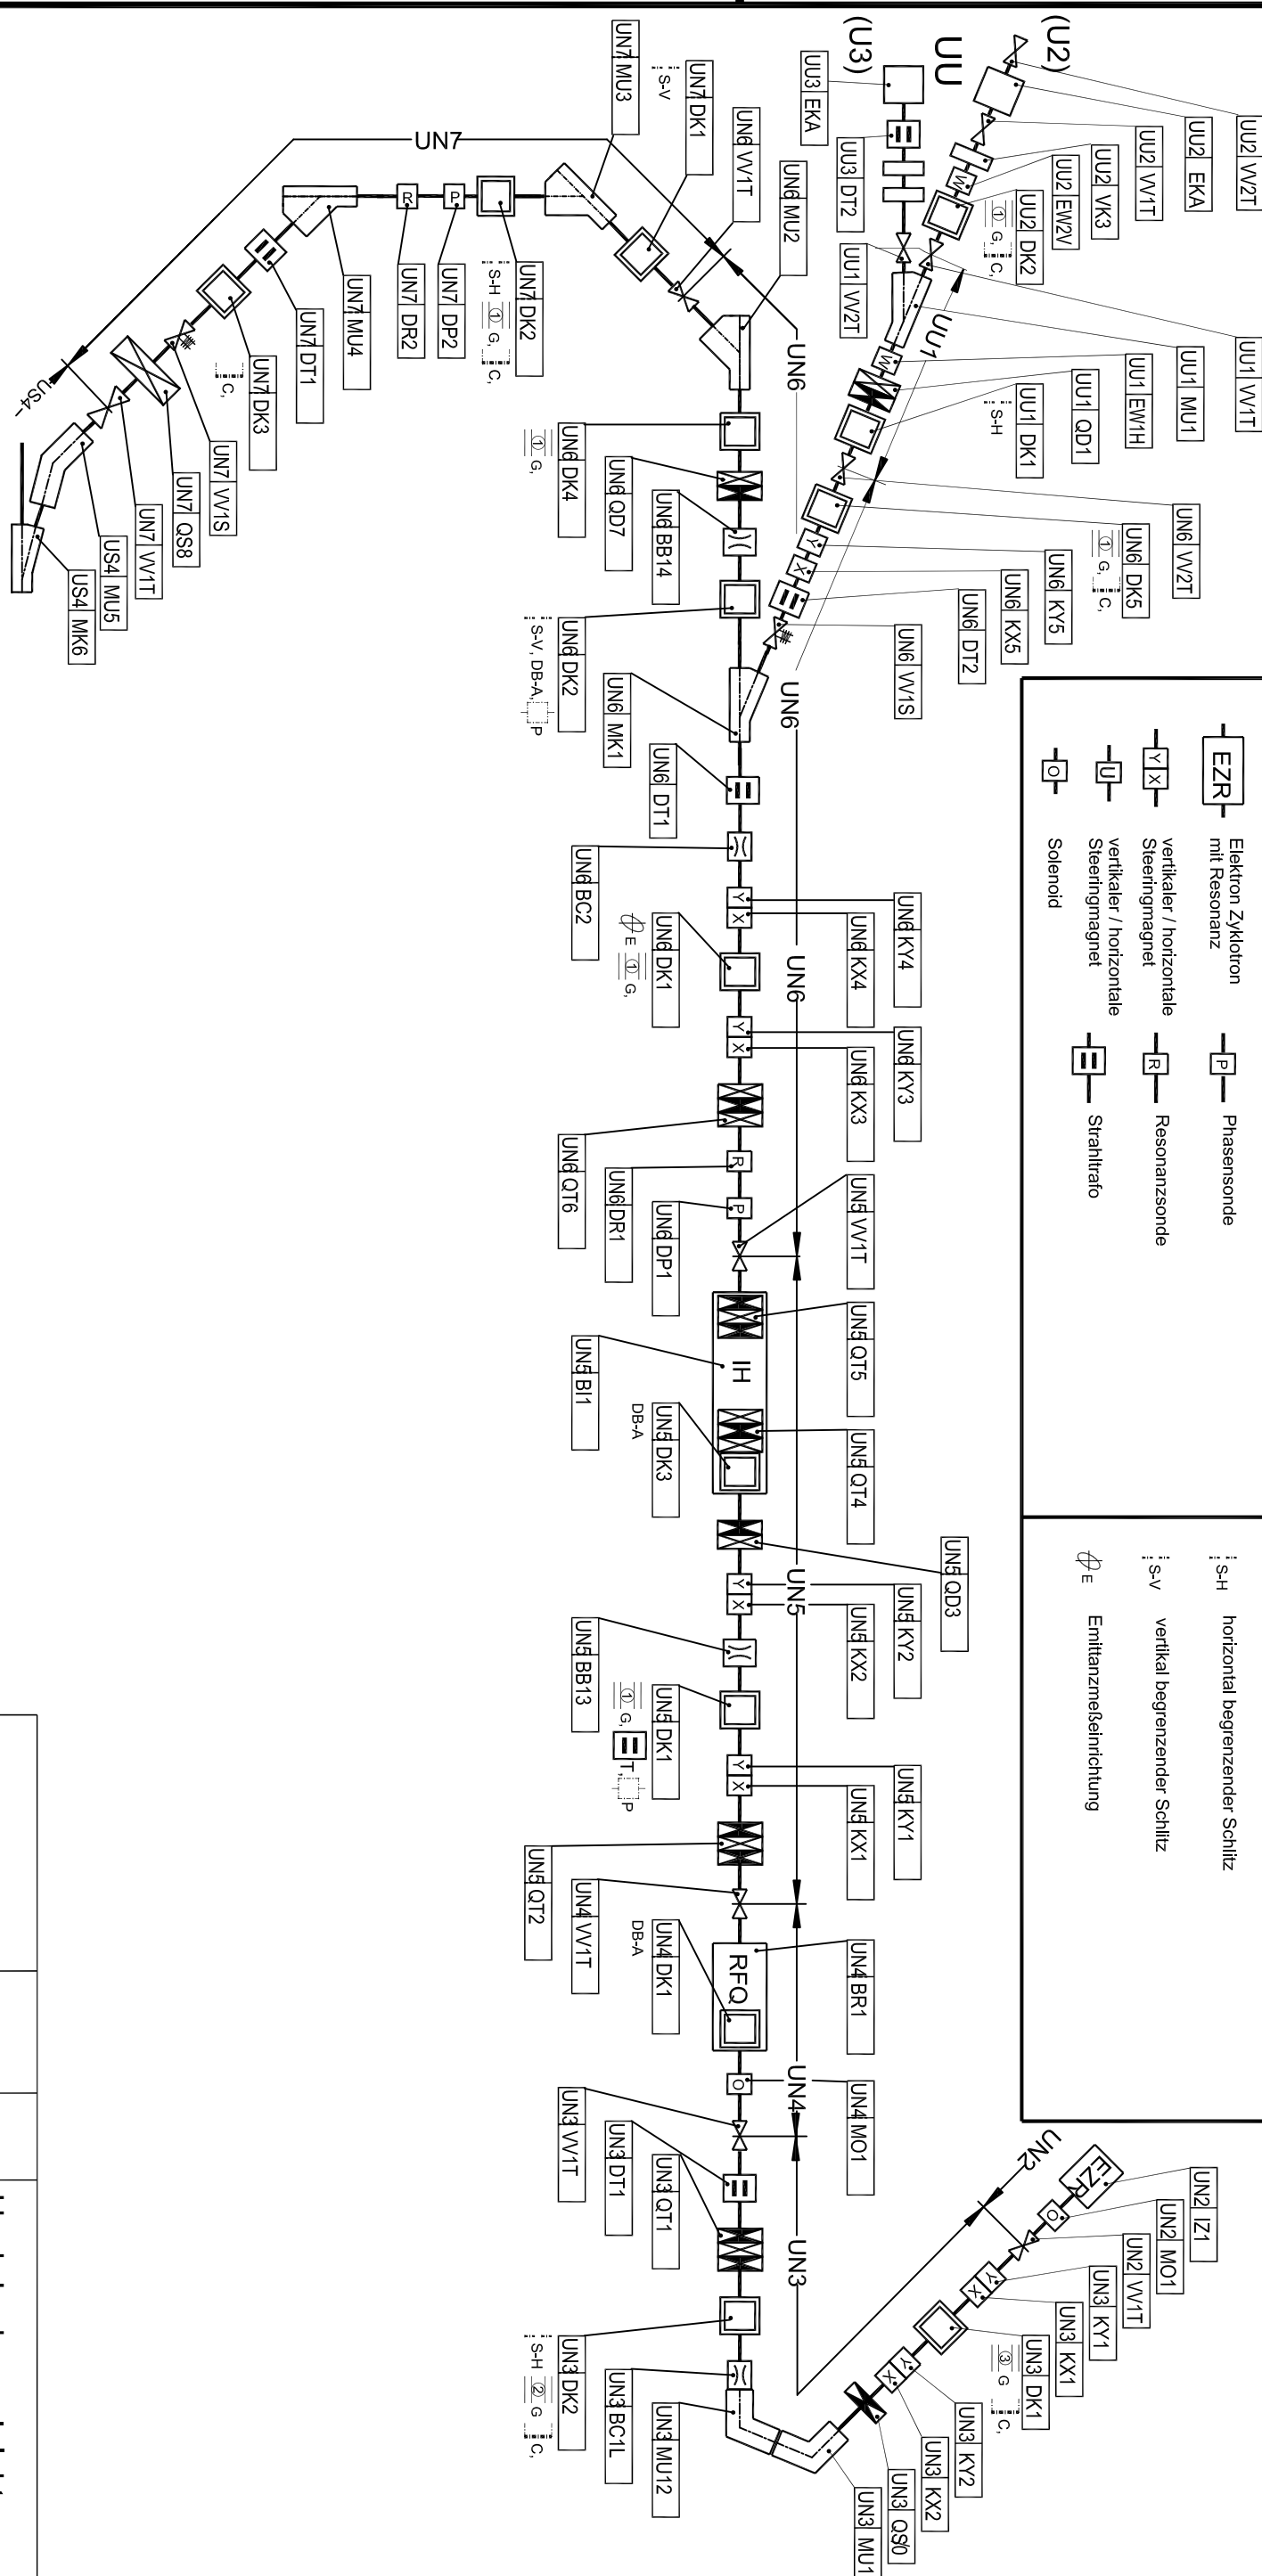

Diagnose Meßsystem

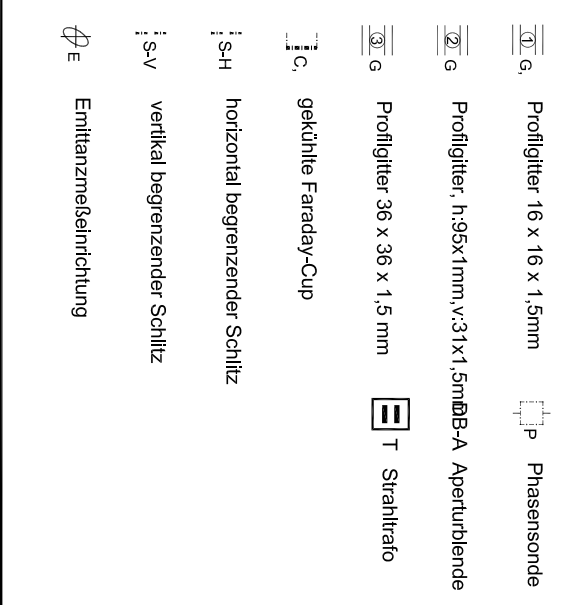

Hoch-Ladungs-Injektor		Name	
Strahlführung / Diagnose / Vakuum / Beschleuniger Elemente		IBT	
GS I Darmstadt		Datum 23.06.95	
UNILAC C N 005 011		Gepr. Norm	
Erster für C N 005 010 von 11/90		Blatt	
		Bl.	