


2. Injektor am HLI (Entwurf Februar 2009)

Beschluß: Vorschlag 3 (s. Abb.) wird favorisiert:

- Der Zugang zu den Strahlführungs- und –diagnoseelementen der alten Strahllinie wird nicht behindert.
- Die Strahldynamik für Vorschlag 2 und Vorschlag 3 ist ähnlich.

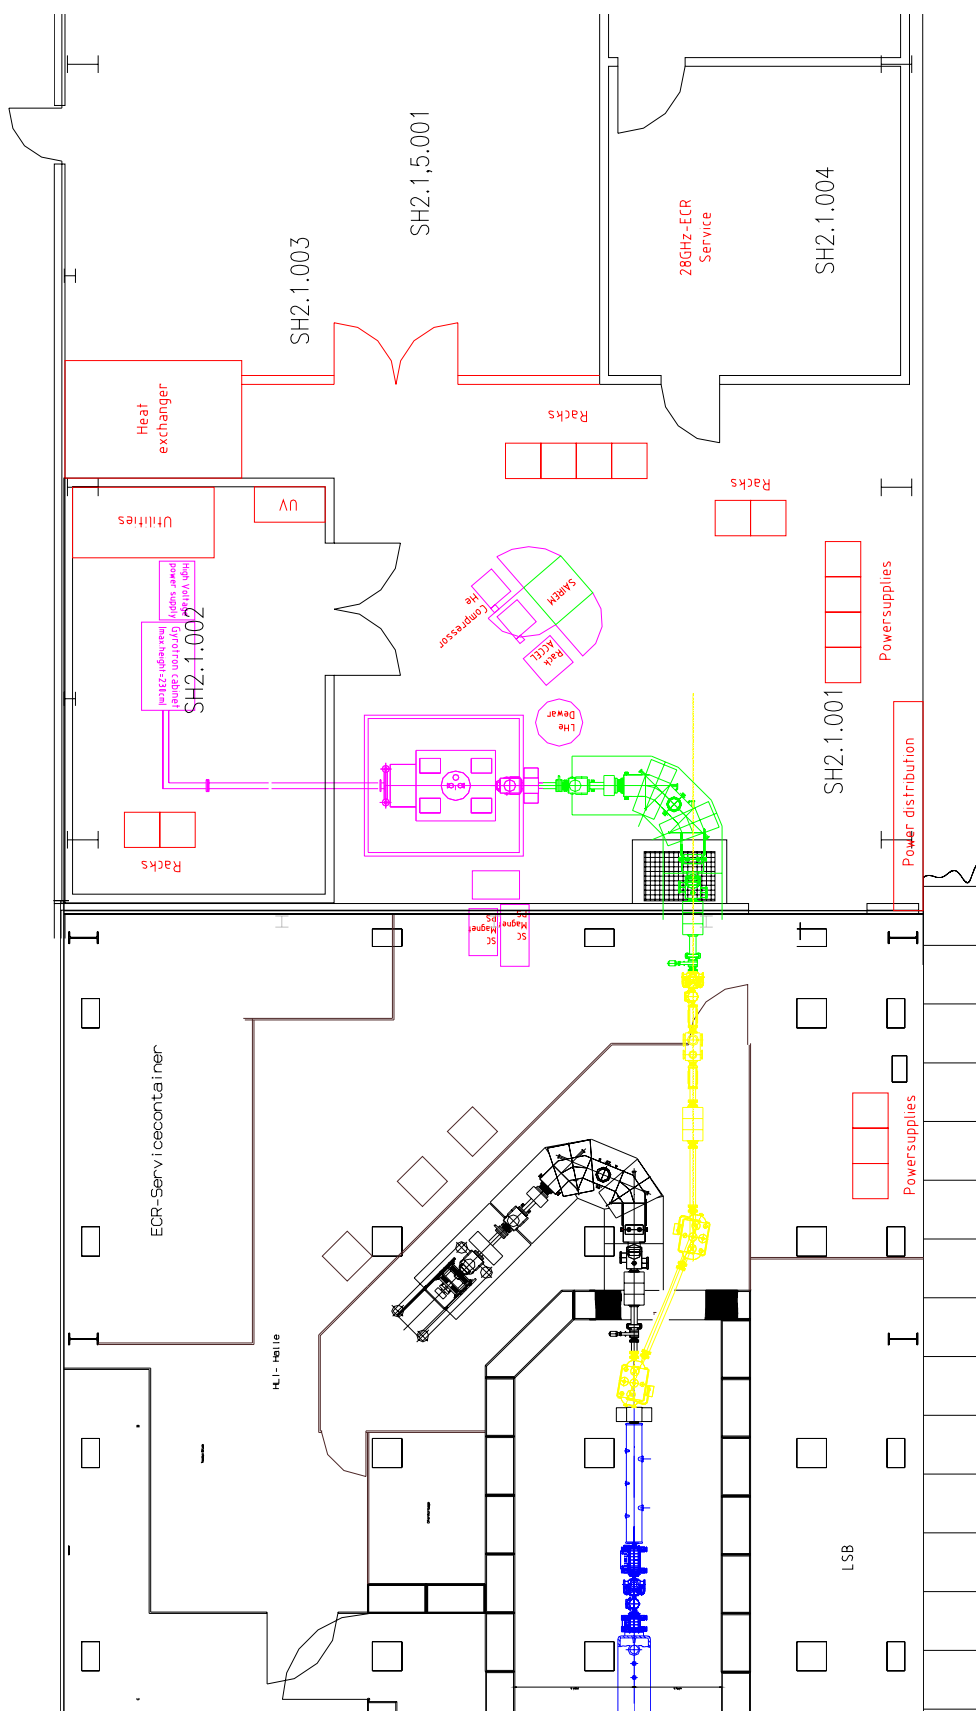

Schematische Skizze zum Vorschlag 3